

# SILLA ADVANCE NEO II GIRATORIA

CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN: 105736800145000054

Ziyaz

## FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA: SILLA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SILLA GIRATORIA CON 4 POSICIONES DE BLOQUEO Y BRAZOS 3D

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1	TIPO	GIRATORIA
2	ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
3	ASENTO	FORRADO EN TELA
4	RESPALDAR	MALLA DE POLIESTER
5	REPOSA BRAZOS	SI, REGULABLES
6	TIPO DE BASE	5 ASPAS
7	COLOR	NEGRO
8	MARCA	ZIYAZ
9	MODELO	SILLA ADVANCE NEO II GIRATORIA
10	EMPAQUE DE FABRICA	NO APLICA
11	UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
12	GARANTÍA	24 MESES CARRY IN
13	CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN	105736800145000054
14	CERTIFICACIONES	CERTIFICADO DE ERGONOMÍA

### IMAGEN DEL PRODUCTO



### CARACTERÍSTICAS

- Silla regulable en altura
- Espaldar de malla poliéster
- Espaldar reclinable
- Soporte lumbar regulable en altura
- Asiento acolchado forrado en tela negra
- Grosor del asiento: 7 cm
- Carcasa de polipropileno bajo el asiento
- Brazos regulables en altura y a los costados
- Mecanismo sincronizado con 4 bloqueos
- Bloqueo de mecanismo para posición de trabajo
- Base de Aluminio de 5 aspas
- Garruchas de nylon
- Procedencia: China
- Garantía de 2 años
- La silla se entrega totalmente armada

### MEDIDAS

- Alto total = De 92 cm a 102 cm.
- Ancho total = De 64 cm a 71 cm
- Profundidad total = 64 cm
- Alto del Espaldar = 48 cm
- Ancho del Espaldar = 48 cm
- Profundidad del asiento = 49 cm
- Ancho del asiento = 50 cm
- Altura del asiento = 44 cm a 54 cm
- Medida del brazo = (8 cm Ancho - largo 27 cm)
- Altura del brazo = De 17 cm a 24 cm
- Diámetro de la base = 66 cm
- Diámetro de las garruchas= 5 cm
- Desplazamiento de amortiguador =10 cm
- Margen de Error = +- 2 cm

### **RECOMENDACIONES DE USO:**

Sentarse apoyando la espalda en el respaldar, regular los brazos al nivel del escritorio o bandeja del teclado. Los pies deben estar en constante contacto con el piso.

**CERTIFICADO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN ERGONÓMICA**

**Medico Ocupacional Evaluador.**

Fernando Manuel Acevedo Espinoza

Médico Especialista en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente

C.M.P: 53581

RNE: 29712

**Solicitante:**

IMAX INT'L S.A.C.

RUC: 20518903960

**Evaluación Requerida:**

Cumplimiento del artículo de la Norma Básica de Ergonomía del Perú – RM 375 – TR, que hace referencia a las características consideradas como ergonómicas en el diseño de las sillas.

La siguiente mercancía fue presentada e identificada por el solicitante como:

**SILLA ADVANCE NEO II GIRATORIA**

**Resultados de la evaluación y verificación:**



Después de la evaluación y verificación se concluye que el modelo de silla en referencia:

Cumple satisfactoriamente con los requisitos en el artículo 17º de la Norma Básica de Ergonomía (RM 375 – 2008 – TR)



Fecha de evaluación: 12/08/2020

  
Fernando M. Acevedo Espinoza  
MÉDICO ESPECIALISTA  
MEDICINA OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE  
C.M.P: 53581 RNE: 29712

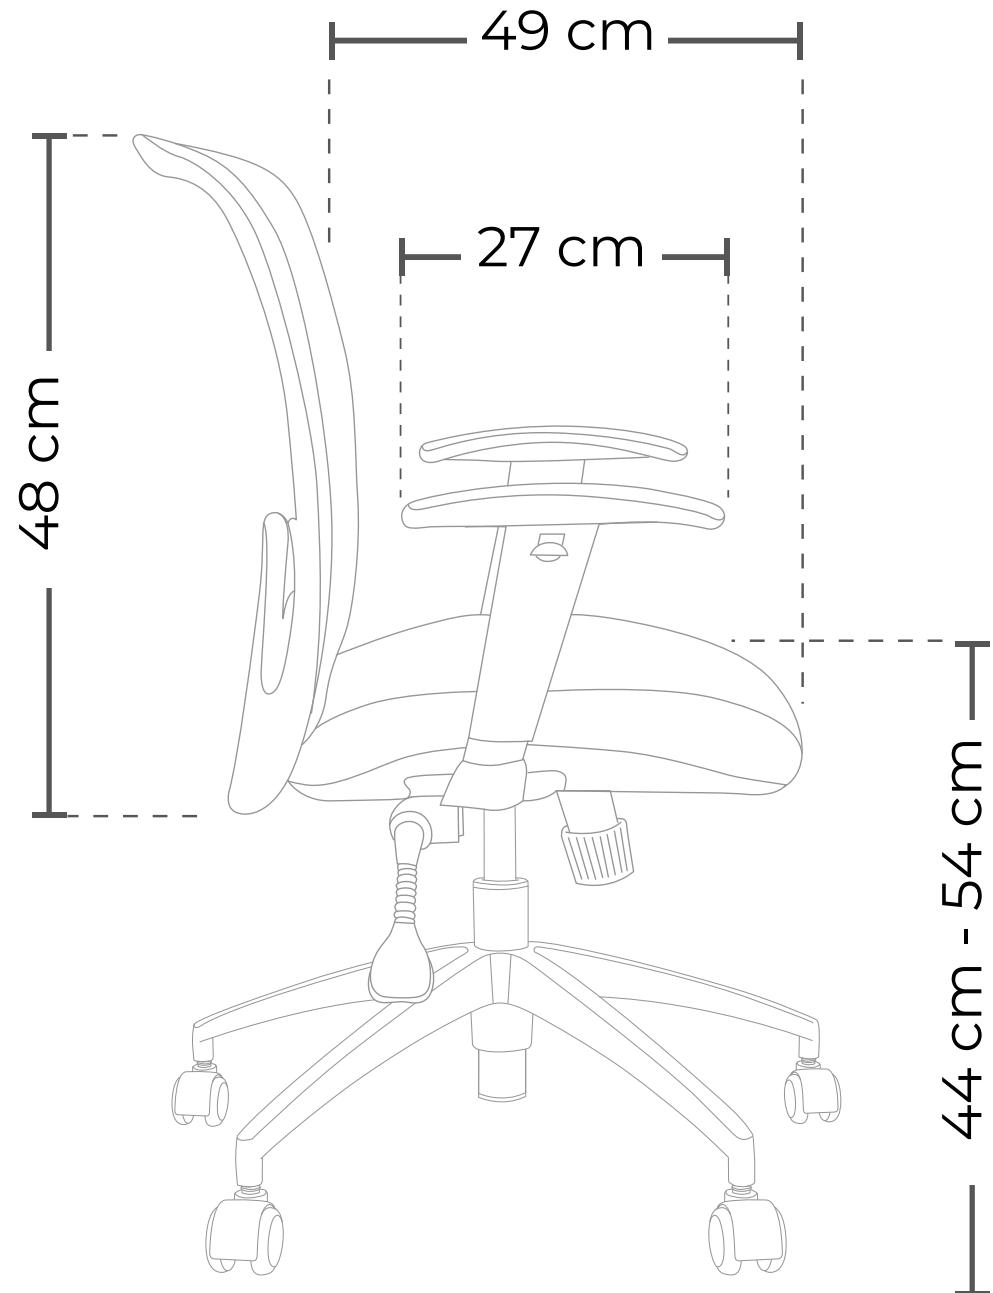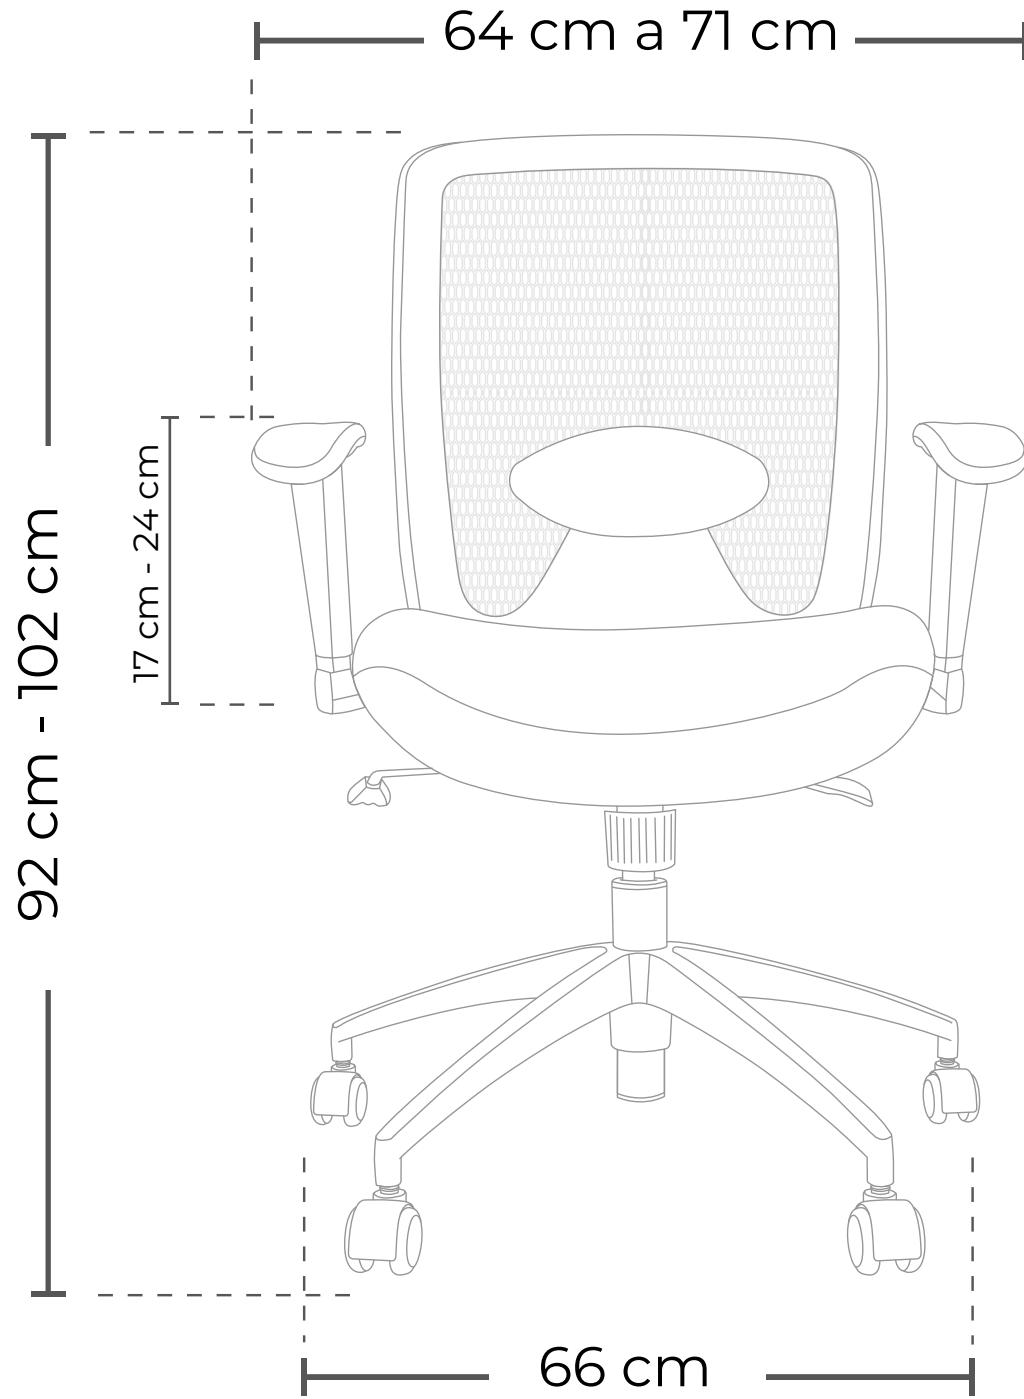

# Ziyaz

## MANUAL DEL USUARIO

SILLA ADVANCE NEO II GIRATORIA





## **1 MECANÍSMOS:**

- A. Up & Down:** Permite subir o bajar la altura de la silla a través de un pistón neumático.
  - B. Synchro:** Este mecanismo permite que el respaldo recline y bloquee en 4 posiciones diferentes, brindando mayor ergonomía y comodidad, adaptándose al peso del usuario al momento del reclinado.
- 2 Respaldar:** Malla tensada de poliéster para mejor ventilación.

- 3 Asiento:** Espuma tapizada en tela.
- 4 Brazos 3D:** Regulables en altura y lados. Con almohadillas tipo gel.
- 5 Estrella:** Aluminio.
- 6 Ajuste del soporte lumbar:** Reforzado y regulable en altura.
- 7 Ajuste de tensión de reclinación del mecanismo.**

1

## **A. Ajuste de altura del asiento:**

Sistema up & down , el cual permite subir o bajar la altura de la silla a traves de un pistón neumático, que le facilitará posicionarse en la altura deseada o de acuerdo a la estatura de cada usuario.



Altura máxima y mínima del asiento



El sistema se acciona pulsando hacia arriba la palanca situada en el lado derecho en la posición de sentado.



## **B. Ajuste del modo reclinación:**

Sistema Synchro, este mecanismo permite que el espaldar recline y bloquee en 4 posiciones diferentes, brindando mayor ergonomía y comodidad, adaptándose al peso del usuario al momento del reclinado.

La reclinación del espaldar se acciona moviendo la palanca hacia arriba. Se elige la inclinación deseada y se bloquea accionando la misma palanca hacia abajo. La palanca está situada en lado izquierdo de la silla, en la posición de sentado.



2

## Ajuste de los brazos 3D:

Regulable en altura y lados. Pueden adaptarse a la altura del escritorio para mayor ergonomía. Su función hacia los costados facilitará su estancia en la silla, de acuerdo a la contextura de cada usuario. Tiene almohadillas tipo gel para mayor comodidad.



Girando la perilla hacia la izquierda podrá liberar el bloqueo del brazo permitiendo ajustarlo hacia el costado en la posición deseada, debe girar hacia la derecha la misma perilla para fijar la posición del mismo.

Pulsando el botón, situado en la parte inferior del reposabrazo, podrá ajustar el brazo a la altura deseada.

**3**

## **Ajuste de tensión de reclinación del mecanismo:**

Cuenta con un sistema para regular la tensión al momento del reclinado, brindando mayor adaptación dependiendo del peso de cada usuario. Puede regular la tensión girando el tambor ubicado en la parte inferior del asiento.



Gira el tambor hacia la derecha o izquierda para regular la tensión. Se recomienda regularlo de acuerdo al peso.

**4**

## **Ajuste del soporte lumbar:**

Dispone de un SOPORTE LUMBAR REFORZADO en el espaldar para brindar mayor comodidad y ergonomía. El soporte lumbar reforzado tiene un recorrido vertical que permite adaptarlo según la preferencia de cada usuario



El soporte lumbar reforzado puede regularse en altura de forma manual, podrá ajustarlo en diferentes niveles.



**Ziyaz**